



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N29-2018
"ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO"
CON CARGO A RECURSOS ESTATALES,
EJERCICIO FISCAL 2019.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL 15 DE MARZO DE 2019, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO., SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N29-2019 "ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO", EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

LABORATORIOS LICON S.A. PRESENTA CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR SIN REALIZAR PREGUNTAS

1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 A LAS 14:00 HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.

2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.

5.- LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA No. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.

6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL



ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

LOS LICITANTES PARTICIPANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

DISEQUI, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. REFERENCIA: PÁG. 7, NUMERAL 1.4. "LUGAR DE ENTREGA DEL ARRENDAMIENTO" PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLÍE LOS HORARIOS DE ENTREGA DE 08:00 A 14:00 HORAS EN LOS LABORATORIOS DE CADA HOSPITAL, YA QUE, DEBIDO A LA LOGÍSTICA DE REPARTO, RESULTA DIFÍCIL ENTREGAR MATERIALES, REACTIVOS Y BIENES DE CONSUMO ANTES DE LAS 12:00 DEL DÍA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 2. REFERENCIA: PÁG. 13, DOCUMENTO VI. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR EN NUESTRA PROPUESTA, LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTÉN EN OTRO IDIOMA, ÚNICAMENTE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

PREGUNTA 3. REFERENCIA: PÁG. 13, DOCUMENTO VI. REGISTROS SANITARIOS. PREGUNTA: EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS O SUMINISTROS SOLICITADOS NO REQUIERAN REGISTROS SANITARIOS ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE PODAMOS INTEGRAR LA CARÁTULA Y EL PUNTO REFERENCIADO DE LA PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA COFEPRIS MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS QUE SON DE BAJO RIESGO Y POR LO CUAL NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO?

RESPUESTA: SE ACEPTA

PREGUNTA 4. REFERENCIA: PÁG. 17, DOCUMENTO VI. "PRESENTACIÓN E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA", 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR GANADOR, BUSCAR UN LABORATORIO PARA PROCESAR LAS MUESTRAS EN EL CASO ARRIBA MENCIONADO (SUBROGACIÓN EXTRAORDINARIA). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO DEBEMOS INTEGRAR UN LISTADO DE LABORATORIOS DONDE EN CASO DE NECESIDAD, SE SUBROGARÁ EL SERVICIO DE LABORATORIO ¿ES CORRECTO? --

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 5. REFERENCIA: PÁG. 18, DOCUMENTO IV. "FORMATO QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN CASO DE EXISTIR IGUALDAD DE CONDICIONES, SE DARÁ PREFERENCIA A LAS PERSONAS QUE INTEGREN EL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL ESTADO (ANEXO NO. 6)". PREGUNTA: EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA QUE NO FORME PARTE DEL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, DEBIDO A QUE SU ESTRATIFICACIÓN ES DE EMPRESA "GRANDE", ENTENDEMOS QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A LLENAR EL ANEXO NO. 6 Y QUE BASTARÁ CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PREGUNTA 6. REFERENCIA: PÁG. 18, DOCUMENTO XI. LOS LICITANTES DEBEN INTEGRAR EN SU PROPUESTA COPIA LEGIBLE Y CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO ISO 13485 Y CERTIFICADO ISO 9001: 2015 PARA LOS CORRESPONDIENTES EQUIPOS Y REACTIVOS OFERTADOS. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, DEBERÁ PRESENTARSE AL MENOS UNO DE LOS CERTIFICADOS QUE SOLICITA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO XI DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 7. REFERENCIA: PÁG. 18, DOCUMENTO XI. LOS LICITANTES DEBEN INTEGRAR EN SU PROPUESTA COPIA LEGIBLE Y CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO ISO 13485 Y CERTIFICADO ISO 9001: 2015 PARA LOS CORRESPONDIENTES EQUIPOS Y REACTIVOS OFERTADOS, VIGENTES HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO Y LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EN EL CUAL SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA VIGENTE, SEGÚN CORRESPONDA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS CUENTE CON UN ISO 9001: 2008 VIGENTE, NOS PERMITA INTEGRARLO EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO XI DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 8. REFERENCIA: PÁG. 18, DOCUMENTO XI. LOS LICITANTES DEBEN INTEGRAR EN SU PROPUESTA COPIA LEGIBLE Y CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO ISO 13485 Y CERTIFICADO ISO 9001: 2015 PARA LOS CORRESPONDIENTES EQUIPOS Y REACTIVOS OFERTADOS, VIGENTES HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO Y LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EN EL CUAL SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA VIGENTE, SEGÚN CORRESPONDA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS CERTIFICADO DE LIBRE VENTA SON PARA QUE LOS FABRICANTES PUEDAN EXPORTAR SUS EQUIPOS Y/O SUMINISTROS MÉDICOS HACIA EL EXTRANJERO Y NO HACEN MENCIÓN SOBRE LA "BUENA PRÁCTICA DE MANUFACTURA", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR DICHOS CERTIFICADOS SIN QUE DEBA DEMOSTRARSE ESE REQUERIMIENTO. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO XI DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 9. REFERENCIA: PÁG. 19, DOCUMENTO XII. CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS, SOLUCIONES, CONTROLES, CALIBRADORES, MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRA, BIENES OFERTADOS DE CUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, MISMA QUE DEBERÁ TENER FIRMA AUTÓGRAFA DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA EMPRESA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE DICHO DOCUMENTO, POR LO QUE DE NO PRESENTARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, DEBIDO A LA NATURALEZA DE AGARES Y ALGUNOS CONTROLES, SE NOS PERMITA UNA CADUCIDAD DE NO MENOS DE 2 MESES ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA CON CARTA GARANTÍA DE CANJE EN EL CASO DE MICROBIOLOGÍA Y DEBERÁ DE ANEXARLA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EL NO PRESENTARLA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN-----

PREGUNTA 10. REFERENCIA: PÁG. 29, ANEXO 1A, REFERENCIA NO. 18 – ELECTROLITOS. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN DICHO ANEXO NO SE SOLICITA PRUEBAS DE ELECTROLITOS, DEBEMOS ENTENDER QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A INTEGRAR EN NUESTRA PROPUESTA, FICHA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN REGULATORIA DEL EQUIPO DE LABORATORIO QUE REALIZA ESTA PRUEBA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3 de 11
[Handwritten marks]



PREGUNTA 11. REFERENCIA: PÁG. 47, A) TOMA DE MUESTRAS: TUBO PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO, APLICADO POR ASPERSIÓN EN LA PARED DEL TUBO, TAPÓN AZUL VOLUMEN DE DRENADO 4.0 ML (+0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPÓN DE SEGURIDAD. ESTÉRIL.
PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL TUBO DESCRITO EN ESTE PUNTO, PERO CON UN PLÁSTICO DE PET AL VACÍO DE 12 X 75 ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 12. REFERENCIA: PÁG. 47, A) ENVASE ESTÉRIL DE 2 L PARA RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HRS.
PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA PRUEBA NO ESTÁ SIENDO SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO DE PRUEBAS DE LA PARTIDA 1 A, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR LA OFERTA O SURTIMIENTO DEL ENVASE ESTÉRIL DE 2 L PARA RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----

PREGUNTA 13. REFERENCIA: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE MUEVA LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR LAS CARTAS DE APOYO CON LA FECHA ORIGINAL DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DETALLADA EN LAS BASES ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA -----

CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTAS LEGAL – ADMINISTRATIVAS -----

PREGUNTA 1.- 2.3.3 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. DOCUMENTO IX
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE, PARA AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE NO APLICA A MI REPRESENTADA SE PERMITA PRESENTAR ANEXO (EN CASO DE EXISTIR) CON MARCA DE AGUA NO APLICA ACOMPAÑADO DE UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO CITADO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA -----

PREGUNTA 2.- 2.4 PROPOSICIONES CONJUNTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE, PARA AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE NO APLICA A MI REPRESENTADA SE PERMITA PRESENTAR ANEXO (EN CASO DE EXISTIR) CON MARCA DE AGUA NO APLICA ACOMPAÑADO DE UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO CITADO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA -----

PREGUNTA 3.- 2.5 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR EN EL AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, UNA PERSONA DIFERENTE A QUIEN FIRMA LA PROPUESTA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, ACREDITANDO MEDIANTE CARTA PODER, ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA -----

PREGUNTAS TÉCNICAS -----



PREGUNTA 4.- 2.3.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. 1) ASISTENCIA TÉCNICA. PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO. PÁG. 13. DEBEMOS ENTENDER QUE LAS CARTAS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE PUNTO SOLO LA DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 5.- 2.3.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. 1) ASISTENCIA TÉCNICA. PÁG. 14. DICE: "SE DEBERÁ ENTREGAR MANUAL DE USO DE CADA EQUIPO DE LABORATORIO, EN ESPAÑOL" DEBEMOS ENTENDER QUE LOS MANUALES DE USO DE CADA EQUIPO DEBERÁN SER ENTREGADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 6.- 2.3.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. 1) ASISTENCIA TÉCNICA. PÁG. 15. INCISO E) CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL EN TEMAS DE QUÍMICA CLÍNICA, HEMATOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA, UROANÁLISIS, Y OTROS RELACIONADOS, ASÍ COMO DESARROLLO PERSONAL. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PODRÁ PRESENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROPUESTO EL CUAL SE CONCILIARÁ CON CADA JEFE DE LABORATORIO PARA ESTABLECER LAS FECHAS MÁS APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO DICHA CAPACITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 7.- DOCUMENTO XI. PÁG. 18 Y 19. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS PRESENTAR CERTIFICADO ISO 13485 QUE ES EL QUE APLICA A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ASÍ COMO SU CERTIFICADO DE LIBRE VENTA Y EL ISO 9001:2015 (QUE ES LA QUE APLICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD) DE LA EMPRESA LICITANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?. FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 8.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42 CARACTERÍSTICA 5. DICE: "RANGO DE LONGITUD DE ONDA MÍNIMO DE 340 A 800 NANÓMETROS". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 670 NM, CON EL CUAL NO SE VE AFECTADO EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1-B DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 9.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 6. DICE: "SISTEMA FOTOMÉTRICO CON 12 LONGITUDES E INTERMEDIAS COMO MÍNIMO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SISTEMA FOROMETRICO CON 8 LONGITUDES DE ONDA COMO MÍNIMO, CON EL CUAL NO SE VE AFECTADO EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



PREGUNTA 10.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 7. DICE: "CAPACIDAD DE ENSAYO MÍNIMO DE 300 PRUEBAS POR HORA." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ENSAYO MÍNIMO DE 100 PRUEBAS POR HORA, RENDIMIENTO CON EL QUE SE RESUELVE HOLGADAMENTE LA DEMANDA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1-B DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 11.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 10. DICE: "VOLUMEN DE REACTIVO NO MAYOR A 300 ML." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON VOLUMEN DE REACTIVO NO MAYOR A 450 ML, VOLUMEN CON EL CUAL NO SE VE AFECTADO EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 12.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA BAJO RENDIMIENTO, PÁG. 43. CARACTERÍSTICA 5. DICE: "MÍNIMO 40 REACTIVOS A BORDO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON BANDEJA DE REACTIVOS CON MÍNIMO 35 POSICIONES PARA REACTIVOS A BORDO, CON EL CUAL NO SE VE AFECTADA LA PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDAD Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 13.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA UROANALISIS MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 44. CARACTERÍSTICA 5. DICE: "3 LONGITUDES DE ONDA 460, 550, 650 NM." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON BANDEJA DE REACTIVOS CON 3 LONGITUDES DE ONDA 460, 450, 630 NM, CON EL CUAL NO SE VE AFECTADO EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 14.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA BIOMETRIA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO, PÁG. 45. CARACTERÍSTICA 9. DICE: "CON COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO E IMPRESORA LÁSER) ADICIONAL AL EQUIPO, PARA LA INTERFACE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON INTERFASE R232, USB Y ETHERNET, ADEMÁS DE PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO OFERTADO PARA BIOMETRÍA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO ES COMPATIBLE CON EL SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA COMO TAL NO ES REFERENCIABLE EN LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----



PREGUNTA 15.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 3. DICE: "ISE PARA ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL, YA QUE EN EL ANEXO No. 1-B NO SE SOLICITA LA PRUEBA DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----

PREGUNTA 16.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 43. CARACTERÍSTICA 20. DICE: "-CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS...", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL YA QUE EN EL CARRUSEL DE REACTIVOS Y MUESTRAS TIENEN UNA POSICIÓN DEFINIDA LA CUAL FACILITA AL USUARIO LA UBICACIÓN DE REACTIVOS Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 17.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 11. DICE: "CON CAPACIDAD DE AUTO-DILUCIÓN PARA MUESTRAS PATOLÓGICAS". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL YA QUE EN LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS EL USUARIO TOMA UN CRITERIO EN BASE A SUS CONOCIMIENTOS QUE CARACTERÍSTICAS DEBIERA TENER LA DILUCIÓN DE LA MUESTRA PATOLÓGICA Y PROGRAMAR EL INSTRUMENTO PARA LLEVAR A CABO DICHA DILUCIÓN ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 18.- ANEXO No. 1-B. PAQUETE DE INSUMOS PARA FASES PREANALÍTICA, POSTANALITICA, TOMA DE MUESTRAS, PÁG. 53. INCISO A). DICE: "TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE.... TAPÓN ROJO/GRIS O TAPÓN ORO, VOLUMEN DE DRENADO 6 ML...." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE DE PLÁSTICO PET AL VACÍO SIN ANTICOAGULANTE, TAPÓN ORO, CON VOLUMEN DE DRENADO DE 5ML, YA QUE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO ACTUALMENTE. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 19.- ANEXO 1-B. PRUEBAS INMUNOLÓGICAS MANUALES, PÁG.47. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, CON LA FINALIDAD DE PODER OFERTAR LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS, LAS PRUEBAS INMUNOLÓGICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PUEDAN SER OFERTADAS COMO PRUEBAS MANUALES. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 20.- SUBNUMERAL 1.3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. PÁG. 7. SOLICITA LA CONVOCANTE QUE EL PROVEEDOR GANADOR TENGA UN LABORATORIO DE SUBROGACIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR UN ORGANISMO EXTERNO Y SE DEBE PRESENTAR REGISTRO DE INSCRIPCIÓN Y LAS EVALUACIONES DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS DE DICHO PROGRAMA, ASÍ COMO COPIA DEL RESPONSABLE SANITARIO. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ INTEGRAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA CORRESPONDIENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----



PREGUNTA 21.- 2.3.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. 1) ASISTENCIA TÉCNICA. PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO. PÁG. 13. DICE: "DE LOS EQUIPOS QUE COMPRENDE: QUÍMICA CLÍNICA (EL TIPO DE DETERMINACIONES SE SEÑALA EN LOS ANEXOS No. 1-A Y 1-B: HEMATOLOGÍA (BIOMETRÍA HEMÁTICA), COAGULACIÓN, URINANÁLISIS (EXAMEN GENERAL DE ORINA), ELECTROLITOS, GASOMETRÍAS, MICROBIOLOGÍA Y PRUEBAS INMUNOLÓGICAS...." DEBEMOS ENTENDER QUE LA PRESENTE LICITACIÓN SOLO COMPRENDERÁ LA DEMANDA DE PRUEBAS Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA QUÍMICA CLÍNICA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, HEMATOLOGÍA, URINANÁLISIS, ELECTROLITOS Y PRUEBAS INMUNOLÓGICAS, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS No. 1-A Y 1-B. YA QUE PARA LOS DEMÁS PAQUETES NO EXISTE DEMANDA DE **GASOMETRÍAS Y MICROBIOLOGÍA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.**-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 22.- ANEXO 1-B. PÁG.41. DICE: "PARTIDA No. 18. ELECTROLITOS". DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE QUE SEAN OFERTADAS LA PRUEBAS DE ELECTROLITOS SODIO (NA), POTASIO (K) Y CLORO (CL). **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.**-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 23.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MINIMAS). PÁG. 42 A LA 46. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARA LOS EQUIPOS QUE OFERTEMOS PARA EL EQUIPAMIENTO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1-B, ENTREGAREMOS LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, OPERACIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN, ASÍ COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO; YA QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS NO SON REFERENCIABLES EN LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----

PREGUNTA 24.- ANEXO No. 1-B. PAQUETE DE INSUMOS PARA FASES PREANALITICA, POSTANALITICA, TOMA DE MUESTRAS. C) FASE ANALÍTICA PÁG. 54 EN LA FASE ANALÍTICA DE QUÍMICA CLÍNICA PAGINA 54, DICE: JUEGO DE MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE: 5 A 100 ML, 100 A 1000ML; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE ENTREGAR PIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE DE 10 A 100 ML Y DE 100 A 1000ML, YA QUE NO EXISTEN PIPETAS DE .5 A 100 ML EN EL MERCADO, SIN QUE ESTO INTERFIERA AL PROCESAMIENTO DE LA FASE ANALÍTICA DE LA LÍNEA DE QUÍMICA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 25.- ANEXO No. 1-B. SOFTWARE Y HARDWARE. PÁG. 47 EN LO QUE SE REFIERE AL SOFTWARE Y HARDWARE, PARA PODER UTILIZAR EL REPORTEADOR EN TIEMPO REAL SE REQUIERE QUE LA RED DE LABORATORIOS (CENTROS DE SALUD), MANEJEN EN SUS LABORATORIOS EL ACCESO A INTERNET, PARA PODER MONITOREAR EN TIEMPO REAL LA INFORMACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTA PARTE DEL MANEJO DEL REPORTEADOR SEA CONSIDERADA COMO OPCIONAL, YA QUE NUESTRO SOFTWARE DE INTERFACE SE ENCARGA DE OBTENER LAS ESTADÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO EN MENCIÓN Y EN LO QUE RESPECTA AL NIVEL DE ABASTO Y SUMINISTROS NUESTROS EJECUTIVOS SE ENCARGAN DE MONITOREARLOS EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----



PREGUNTAS ECONÓMICAS

PREGUNTA 26.- ANEXO No. 1-A, 1-B. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA DEMANDA PRESENTADA EN LOS ANEXOS 1-A, 1-B, ES POR EL TOTAL DEL PERIODO O MENSUAL, FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: POR EL TOTAL DEL PERIODO

PREGUNTA 27.- ANEXO No. 1-A, 1-B. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REALIZARÁ UNA PROPUESTA ECONÓMICA CON BASE AL ANEXO 3 PARA CADA PARTIDA, CONSIDERANDO LAS DEMANDAS DEL ANEXO 1-A, 1-B, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 28.- ANEXO No. 3 PAG. 57. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL ANEXO 3, EN EL APARTADO: **MONTO TOTAL**, SE DEBE CAPTURAR EL MONTO TOTAL CON I.V.A. O MONTO TOTAL SIN I.V.A., FAVOR DE ACLARAR

RESPUESTA: ES POR EL MONTO TOTAL CON I.V.A.

PREGUNTA 29.- ANEXO No. 3 PAG. 57. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL ANEXO 3, EN EL APARTADO: **ANEXO No.** DEBEMOS INDICAR SOLAMENTE EL NUMERO 3, FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: DEBERÁ DE ELABORAR UN ANEXO PARA CADA PARTIDA

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **14:25 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



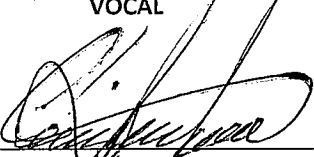


COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA


M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H.

SECRETARIO EJECUTIVO

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS


<p>VOCAL</p> <p> C. GENARO GÓMEZ VARGAS REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>VOCAL</p> <p> L.T.S. LETICIA RANGEL CANO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN</p>
<p>VOCAL</p> <p> L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN</p>	<p>VOCAL</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA</p>
<p>VOCAL</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA</p>	<p>ASESOR</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS</p>
<p>ASESOR</p> <p> ARQ. JUAN JOSÉ LOZANO JACOBO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS S.S.H.</p>	<p>ASESOR</p> <p> L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>
<p>ASESOR</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>	<p>ASESOR</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>

ÁREA TÉCNICA

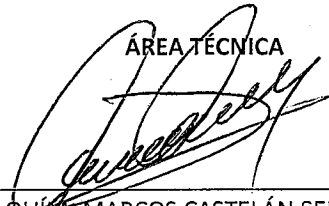


QUIMI. MARCOS CASTELÁN SERRANO
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PÚBLICA DE HIDALGO

LICITANTE

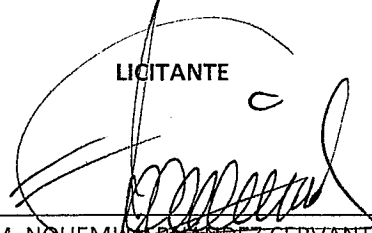

QUIM. NOEMÍ HERNÁNDEZ CERVANTES
DISEQUI, S.A. DE C.V.

LICITANTE



I.Q.I. CARLOS ROBERTO MEJÍA MONDRAGÓN
CENTRUM PROMOTORA
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

LICITANTE



LIC. ROSALBA CORONA ARREGOITTE
LABORATORIOS LICON S.A.