



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N40-2019
"ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO",
SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
CON CARGO A RECURSOS ESTATALES,
EJERCICIO FISCAL 2019.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 10 DE ABRIL DE 2019, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO., SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N40-2019 "ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

SE ENCUENTRA COMO OBSERVADOR EL I.Q.I. CARLOS ROBERTO MEJÍA MONDRAGÓN, DE LA EMPRESA CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS LICON, S.A. DE C.V. MANDÓ AL CORREO DEL COMITÉ CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR SIN REALIZAR PREGUNTAS

1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 A LAS 11:30 HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.

2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.

(Handwritten signatures and marks)



5.- LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA No. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.

6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

LOS LICITANTES PARTICIPANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

DISEQUI, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. REFERENCIA: PÁG. 13, DOCUMENTO VI. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR EN NUESTRA PROPUESTA, LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTÉN EN OTRO IDIOMA, ÚNICAMENTE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS ¿SE ACEPTA? ---

RESPUESTA: SE ACEPTA

PREGUNTA 2. REFERENCIA: PÁG. 13, DOCUMENTO VI. REGISTROS SANITARIOS. PREGUNTA: EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS O SUMINISTROS SOLICITADOS NO REQUIERAN REGISTROS SANITARIOS ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE PODAMOS INTEGRAR LA CARÁTULA Y EL PUNTO REFERENCIADO DE LA PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA COFEPRIS MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS QUE SON DE BAJO RIESGO Y POR LO CUAL NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO? ---

RESPUESTA: SE ACEPTA

PREGUNTA 3. REFERENCIA: PÁG. 17, DOCUMENTO VI. "PRESENTACIÓN E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA", 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR GANADOR, BUSCAR UN LABORATORIO PARA PROCESAR LAS MUESTRAS EN EL CASO ARRIBA MENCIONADO (SUBROGACIÓN EXTRAORDINARIA). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO DEBEMOS INTEGRAR UN LISTADO DE LABORATORIOS DONDE EN CASO DE NECESIDAD, SE SUBROGARÁ EL SERVICIO DE LABORATORIO ¿ES CORRECTO? ---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 4. REFERENCIA: PÁG. 18, DOCUMENTO IV. "FORMATO QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN CASO DE EXISTIR IGUALDAD DE CONDICIONES, SE DARÁ PREFERENCIA A LAS PERSONAS QUE INTEGREN EL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL ESTADO (ANEXO NO. 6)". PREGUNTA: EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA QUE NO FORME PARTE DEL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, DEBIDO A QUE SU ESTRATIFICACIÓN ES DE EMPRESA "GRANDE", ENTENDEMOS QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A LLENAR EL ANEXO No. 6 Y QUE BASTARÁ CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

PREGUNTA 5. REFERENCIA: PÁG. 19, DOCUMENTO XII. CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS, SOLUCIONES, CONTROLES, CALIBRADORES, MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRA, BIENES OFERTADOS DE CUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, MISMA QUE DEBERÁ TENER FIRMA AUTÓGRAFA DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA EMPRESA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE DICHO DOCUMENTO, POR LO QUE DE NO PRESENTARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, DEBIDO A LA NATURALEZA DE AGARES Y ALGUNOS CONTROLES, SE NOS PERMITA UNA CADUCIDAD DE NO MENOS DE 2 MESES ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA CON CARTA GARANTÍA DE CANJE EN EL CASO DE MICROBIOLOGÍA Y DEBERÁ DE ANEXARLA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EL NO PRESENTARLA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN-----

PREGUNTA 6. REFERENCIA: PÁG. 29, ANEXO 1A, REFERENCIA No. 18 – ELECTROLITOS. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN DICHO ANEXO NO SE SOLICITA PRUEBAS DE ELECTROLITOS, DEBEMOS ENTENDER QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A INTEGRAR EN NUESTRA PROPUESTA, FICHA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN REGULATORIA DEL EQUIPO DE LABORATORIO QUE REALIZA ESTA PRUEBA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 7 REFERENCIA: PÁGS. 39 Y 53, ANEXOS 1-A Y 1-B, A) TOMA DE MUESTRAS: TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 100 MM) ESTÉRIL SIN ANTICOAGULANTE, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; CON RECUBRIMIENTO DE PARTÍCULAS DE SÍLICE 0.70-0.20 MG POR TUBO. TAPÓN ROJO/GRIS O TAPÓ ORO, VOLUMEN DE DRENADO 6 ML, CON O SIN TAPÓN DE SEGURIDAD. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN "TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (12 X 75 MM) ESTÉRIL SIN ANTICOAGULANTE, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO, CON RECUBRIMIENTO DE PARTÍCULAS DE SÍLICE 0.70-0.20 MG POR TUBO. TAPÓN ROJO/GRIS O TAPÓ ORO, VOLUMEN DE DRENADO 4 ML, CON O SIN TAPÓN DE SEGURIDAD. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 8 REFERNCIA: PÁGS. 39 Y 53, ANEXOS 1-A Y 1-B, INCISO A) TOMA DE MUESTRA. "TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13X75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (7.2 MG) APLICADO POR ASPERSIÓN EN LA PARED DEL TUBO CON SILICÓN COMO LUBRICANTE, TAPÓN LILA, VOLUMEN DE DRENADO 4.0 ML (+0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPÓN DE SEGURIDAD. ESTÉRIL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO DE (12X75 MM) DESECHABLE ADULTO CON EDTA K2 (7.2 MG) APLICADO POR ASPERSIÓN EN LA PARED DEL TUBO CON SILICÓN COMO LUBRICANTE, TAPÓN LILA, VOLUMEN DE DRENADO 4.0 ML (+0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPÓN DE SEGURIDAD. ESTÉRIL ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 9 REFERENCIA: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE MUEVA LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR LAS CARTAS DE APOYO CON LA FECHA ORIGINAL DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DETALLADA EN LAS BASES ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ES EL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO -----

PREGUNTA 10 REFERENCIA: ANEXOS 1-A Y 1-B: FICHAS TÉCNICAS PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EN LOS MANUALES Y/O CATÁLOGOS NO SE PUEDA REFERENCIAR ALGÚN PUNTO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS, PERO QUE SI LO CUMPLA, NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA DEL LICITANTE EN DONDE -----

MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LOS ANEXOS 1-A Y 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 11 REFERENCIA: PÁG. 42, ANEXO 1-B: "EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE QUÍMICA CLÍNICA DE ALTO RENDIMIENTO", PUNTO 4: CON CAPACIDAD DE REACTIVOS A BORDO MÍNIMO DE 44. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 32 REACTIVOS A BORDO, YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON TECNOLOGÍA QUE PERMITE LA ALIMENTACIÓN DE REACTIVO SIN QUE SE DETENGA EL PROCESAMIENTO, OFERTANDO ASÍ, UNA MEJORA TECNOLÓGICA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 12 REFERENCIA: PÁG. 42, ANEXO 1-B: "EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE QUÍMICA CLÍNICA DE ALTO RENDIMIENTO", PUNTO 7: UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS POR HORA: MÍNIMO DE 400 PRUEBAS POR HORA SIN INCLUIR ELECTROLITOS POR ISE. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 300 PRUEBAS POR HORA, CON LA TECNOLOGÍA DE ALIMENTACIÓN CONTINUA QUE BENEFICIA LA PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO, LLEGANDO ASÍ A CUMPLIR CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 13 REFERENCIA: PÁG. 42, ANEXO 1-B, "EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO". PUNTO 2: MÍNIMO 60 REACTIVOS A BORDO DEL EQUIPO. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA TECNOLOGÍA DE 45 CANALES, LOS CUALES CONTIENEN HASTA 3 REACTIVOS DISTINTOS POR CARTUCHO, OPTIMIZANDO LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO, SIN AFECTAR LA CANTIDAD DE TEST A REALIZAR ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 14 REFERENCIA: PÁG. 43, ANEXO 1-B, "EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE QUÍMICA CLÍNICA DE BAJO RENDIMIENTO". PUNTO 16: SISTEMA DE INCUBACIÓN SECO PARA CONTROL DE TEMPERATURA. OBLIGATORIO A 37 GRADOS CENTÍGRADOS. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN SISTEMA DE DISCO DE REACCIÓN, EL CUAL MANTIENE CONTROLADA LA TEMPERATURA CONSTANTE DE $37 \pm 0.3^\circ$ C ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES -----

CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTAS LEGAL – ADMINISTRATIVAS -----

PREGUNTA 1.- 2.3.3 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. DOCUMENTO IX SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE, PARA AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE NO APLICA A MI REPRESENTADA SE PERMITA PRESENTAR ANEXO (EN CASO DE EXISTIR) CON MARCA DE AGUA NO APLICA ACOMPAÑADO DE UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO CITADO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----

PREGUNTA 2.- 2.4 PROPOSICIONES CONJUNTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE, PARA AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE NO APLICA A MI REPRESENTADA SE PERMITA PRESENTAR ANEXO (EN CASO DE EXISTIR) CON MARCA DE AGUA NO APLICA ACOMPAÑADO DE UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD LO CITADO. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD-----

PREGUNTA 3.- 2.5 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR EN EL AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, UNA PERSONA DIFERENTE A QUIEN FIRMA LA PROPUESTA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, ACREDITANDO MEDIANTE CARTA PODER, ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD-----

PREGUNTAS TÉCNICAS-----

PREGUNTA 4.- 2.3.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. 1) ASISTENCIA TÉCNICA. PÁG. 15. INCISO E) CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL EN TEMAS DE QUÍMICA CLÍNICA, HEMATOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA, UROANÁLISIS, Y OTROS RELACIONADOS, ASÍ COMO DESARROLLO PERSONAL. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PODRÁ PRESENTAR UN PROGRAMA DE CÁPICITACIÓN PROPUESTO EL CUAL SE CONCILIARÁ CON CADA JEFE DE LABORATORIO PARA ESTABLECER LAS FECHAS MÁS APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO DICHA CAPACITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

PREGUNTA 5.- DOCUMENTO XI. PÁG. 18 Y 19. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS PRESENTAR CERTIFICADO ISO 13485 QUE ES EL QUE APLICA A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ASÍ COMO SU CERTIFICADO DE LIBRE VENTA Y EL ISO 9001:2015 (QUE ES LA QUE APLICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD) DE LA EMPRESA LICITANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?. FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

PREGUNTA 6.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42 CARACTERÍSTICA 5. DICE: "RANGO DE LONGITUD DE ONDA MÍNIMO DE 340 A 800 NANÓMETROS". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 670 NM, CON EL CUAL NO SE VE AFECTADO EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1-B DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 7.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 6. DICE: "SISTEMA FOTOMÉTRICO CON 12 LONGITUDES E INTERMEDIAS COMO MÍNIMO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SISTEMA FOTOMETRICO CON 8 LONGITUDES DE ONDA COMO MÍNIMO, CON EL CUAL NO SE VE AFECTADO EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES-----

PREGUNTA 8.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA BIOMETRIA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO, PÁG. 45. CARACTERÍSTICA 9. DICE: "CON COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO E IMPRESORA LÁSER) ADICIONAL AL EQUIPO, PARA LA INTERFACE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON INTERFASE R232, USB Y ETHERNET, ADEMÁS DE PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO OFERTADO PARA BIOMETRÍA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO ES COMPATIBLE CON EL SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA COMO TAL NO ES REFERENCIABLE EN LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD

PREGUNTA 9.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 3. DICE: "ISE PARA ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL, YA QUE EN EL ANEXO No. 1-B NO SE SOLICITA LA PRUEBA DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 10.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 43. CARACTERÍSTICA 20. DICE: "CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS...", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL YA QUE EN EL CARRUSEL DE REACTIVOS Y MUESTRAS TIENEN UNA POSICIÓN DEFINIDA LA CUAL FACILITA AL USUARIO LA UBICACIÓN DE REACTIVOS Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 11.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 42. CARACTERÍSTICA 11. DICE: "CON CAPACIDAD DE AUTO-DILUCIÓN PARA MUESTRAS PATOLÓGICAS". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL YA QUE EN LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS EL USUARIO TOMA UN CRITERIO EN BASE A SUS CONOCIMIENTOS QUE CARACTERÍSTICAS DEBIERA TENER LA DILUCIÓN DE LA MUESTRA PATOLÓGICA Y PROGRAMAR EL INSTRUMENTO PARA LLEVAR A CABO DICHA DILUCIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 12.- ANEXO 1-B. PRUEBAS INMUNOLÓGICAS MANUALES, PÁG.47. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, CON LA FINALIDAD DE PODER OFERTAR LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS, LAS PRUEBAS INMUNOLÓGICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PUEDAN SER OFERTADAS COMO PRUEBAS MANUALES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 13.- SUBNUMERAL 1.3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. PÁG. 7. SOLICITA LA CONVOCANTE QUE EL PROVEEDOR GANADOR TENGA UN LABORATORIO DE SUBROGACIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR UN ORGANISMO EXTERNO Y SE DEBE PRESENTAR REGISTRO DE INSCRIPCIÓN Y LAS EVALUACIONES DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS DE DICHO PROGRAMA, ASÍ COMO COPIA DEL RESPONSABLE SANITARIO. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ INTEGRAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA CORRESPONDIENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD

PREGUNTA 14.- 2.3.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. 1) ASISTENCIA TÉCNICA. PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO. PÁG. 13. DICE: "DE LOS EQUIPOS QUE COMPRENDE: QUÍMICA CLÍNICA (EL TIPO DE DETERMINACIONES SE SEÑALA EN LOS ANEXOS No. 1-A Y 1-B: HEMATOLOGÍA (BIOMETRÍA HEMÁTICA), COAGULACIÓN, URINANÁLISIS (EXAMEN GENERAL DE ORINA), ELECTROLITOS, GASOMETRÍAS, MICROBIOLOGÍA Y PRUEBAS INMUNOLÓGICAS..." DEBEMOS ENTENDER QUE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL LICITACIÓN SOLO APLICARAN PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA A OFERTAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 15.- ANEXO 1-B. PÁG.41. DICE: "PARTIDA No. 18. ELECTROLITOS". DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE QUE SEAN OFERTADAS LA PRUEBAS DE ELECTROLITOS SODIO (NA), POTASIO (K) Y CLORO (CL). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

PREGUNTA 16.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). PÁG. 42 A LA 46. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARA LOS EQUIPOS QUE OFERTEMOS PARA EL EQUIPAMIENTO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1-B, ENTREGAREMOS LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, OPERACIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN, ASÍ COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO; YA QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS NO SON REFERENCIABLES EN LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD -----

PREGUNTA 17.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA ALTO RENDIMIENTO, PÁG. 42 CARACTERÍSTICA 19. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTÁ CARACTERÍSTICA SEA CONSIDERADA COMO OPCIONAL SIN QUE ESTO INTERVENGA O AFECTE EL RENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS, ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 18.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). DISTRIBUCION DE EQUIPO POR LABORATORIO, PÁG. 47 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BAJO RENDIMIENTO EN EL SEGÚN LA DEMANDA PRESENTADA SIN QUE ESTO AFECTE LA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE ESTA LÍNEA ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 19.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). SOFTWARE Y HARDWARE PÁG. 47. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CARACTERÍSTICA REPORTEADOR / SISTEMA WEB RESPONSIVE, SE CONSIDERE OPCIONAL YA QUE PARA ELLO SE REQUIERE QUE LOS LABORATORIOS CUENTEN CON UNA LÍNEA DE INTERNET Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA DE REDES, ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 20.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MINIMAS). PAQUETE DE INSUMOS PARA FASES PREANALITICA, POSANALITICA, TOMA DE MUESTRAS INCISO C) PÁG. 65 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL INSUMO JUEGO DE MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE: 5 A 100 µL, 100 A 1000µL., NOS PERMITA OFERTAR LA ENTREGA DE LAS MICROPIPETAS DE CUALQUIERA DE LAS DOS CARACTERÍSTICAS ANTES DESCRITAS SIN VERSE AFECTADO LA FASE ANALÍTICA DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS YA QUE ACTUALMENTE EN EL MERCADO SOLO EXISTEN DE 5 A 50 µL, O DE 10 A 100 µL ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES-----

PREGUNTA 21.- 2.3.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. PÁG. 18 NO DEBERÁN DE PRESENTAR OPCIONES TÉCNICAS Y SI LAS PRESENTA SE DESECHARÁ... SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PRESENTAR UNA MEJOR OFERTA ECONÓMICA NOS PERMITA OFERTAR MAS DE UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES, YA QUE ACTUALMENTE SE TIENEN EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.3.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 22.- ANEXO No. 1-B. EQUIPAMIENTO (CARACTERISTICAS MÍNIMAS). EQUIPO PARA UROANALISIS MEDIANO RENDIMIENTO, PÁG. 44 10.- CARACTERÍSTICA 5. DICE: "3 LONGITUDES DE ONDA 460, 550, 630 NM." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON BANDEJA DE REACTIVOS CON 3 LONGITUDES DE ONDA 460, 450, 630 NM, CON EL CUAL NO SE VE AFECTADO EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES CUENTAN CON UN EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES-----

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

PRESIDENTA

SECRETARIO EJECUTIVO

M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H.

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS

VOCAL




C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

VOCAL



L.T.S. LETICIA RANGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL

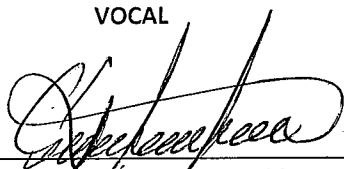


L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

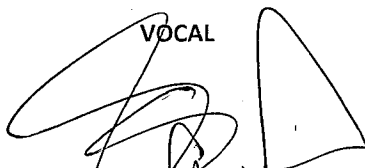


ING. JOSÉ TRINIDAD SALINAS GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

ASESOR

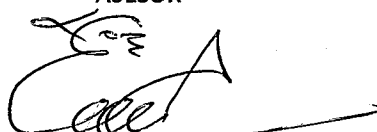


LIC. ELIZABETH AUSTRIA CORTÉS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR

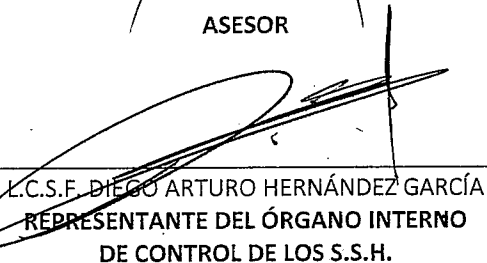


L.C.S.F. DIEGO ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S.S.H.

ASESOR

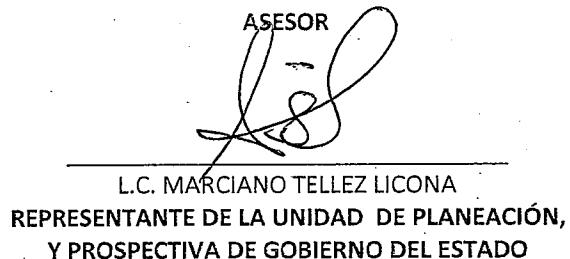


L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

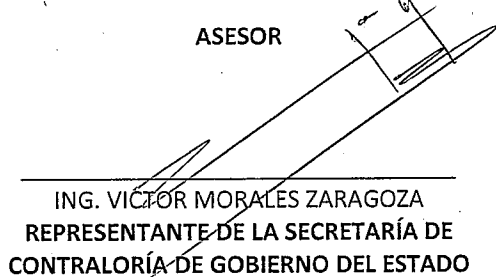

ING. VÍCTOR MORALES ZARAGOZA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

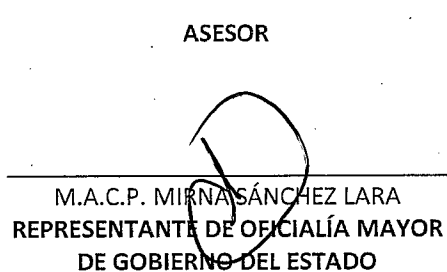


M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA




QFB. CAROLINA TORRES MAGAÑA
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PÚBLICA DE HIDALGO

LICITANTE

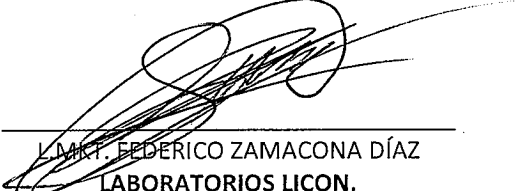


L.MKT. FEDERICO ZAMAONA DÍAZ
LABORATORIOS LICON,
S.A. DE C.V.

LICITANTE



L.A.I. ANA KAREN CRUZ RÍOS
DISEQUI, S.A. DE C.V.

LICITANTE



ING. QUIM. JOSÉ GUADALUPE MOEDANO PAREDES
CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V.